



Компьютерное эргономичное кресло DUOREST Lady DR-7900

Руководство пользователя

Спасибо за выбор компьютерного ортопедического кресла Duorest Lady DR-7900. Duorest заботится о Вашем здоровье!

Данная инструкция предназначена для того, чтобы помочь Вам правильно эксплуатировать кресло, избежать преждевременной поломки или несчастных случаев. **Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию пользователя.**


Внимание!

- 1. Не вставайте на кресло ногами!
- 2. Не прикладывайте больших усилий к механизмам регулировки кресла.
- 3. Помните, что кресло рассчитано только на одного человека!
- Не используйте кресло на скользком полу или неровной бугристой поверхности.
- 5. Кресло не рассчитано на использование на открытом воздухе, в том числе на длительное воздействие солнечного света или в условиях повышенной влажности
- 6. Не оставляйте с детьми без присмотра!
- 7. Не отклоняйтесь в кресле до уровня, когда передние колеса отрываются от пола!
- 8. При отклонении кресла назад не прилагайте дополнительных усилий, отрегулируйте жесткость качания под свой вес.
- 9. Не садитесь и не вставайте ногами на подлокотники!
- 10. Не пробуйте разрезать каучуковые соединители при помощи острых предметов и инструментов!
- 11. Не поднимайте кресло только за один подголовник или за подлокотники!






После вскрытия упаковки проверьте наличие в комплекте данных частей:

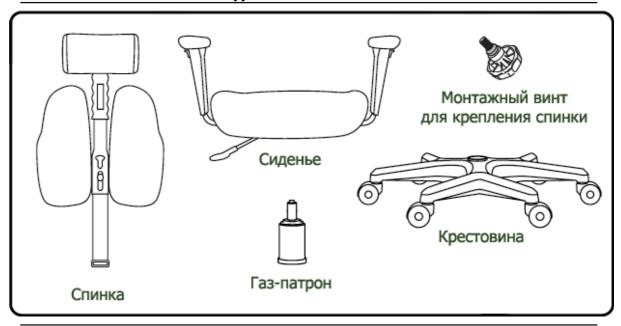

Инструкция по сборке

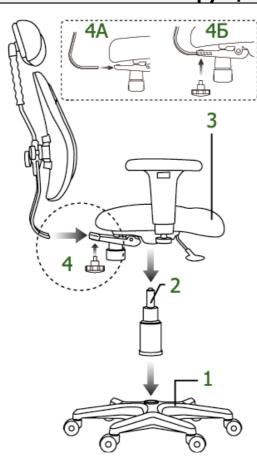


- 1. Поставьте крестовину на пол.
- **2.** Вставьте цилиндр газ-патрона в соответствующее отверстие в центре крестовины.
- **3.** Установите сиденье на газ-патрон, соединенный с крестовиной.
- **4.** При помощи монтажного винта прикрепите спинку к основанию сиденья
 - **5.** Проверьте работоспособность кресла.





Инструкции

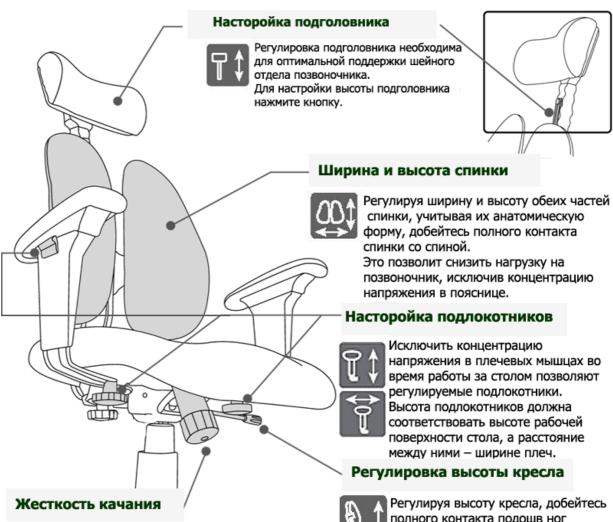




Для настройки жесткости подвески кресла воспользуйтесь регулятором в нижней части сиденья. Эта опция позволяет снизить нагрузку на мышечную систему во время работы.

Регулируя высоту кресла, добейтесь полного контакта подошв ног с поверхностью пола. При этом угол колена должен быть 90 градусов. Такое положение позволяет снизить застой крови в области таза и ног.





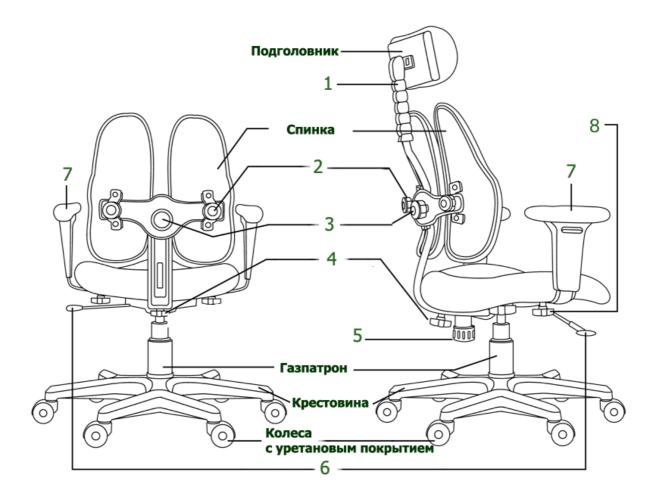

- 1. Регулировка подголовника по высоте.
- 2. Регулировка спинки по ширине.
- 3. Регулировка спинки по высоте.
- 4. Настройка глубины сиденья.
- 5. Регулировка жесткости качания.
- 6. Регулировка кресла по высоте.
- 7. Настройка подлокотников по высоте.
- 8. Настройка расстояния между подлокотниками по ширине.